


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE METROLOŠKE ISPRAVNOSTI TERMOPAROVA I PLATINSKI  
OTPORNIH TERMOMETARA, MERILA SA TERMOPAROVIMA I PLATINSKI OTPORNIM TERMOMETRIMA

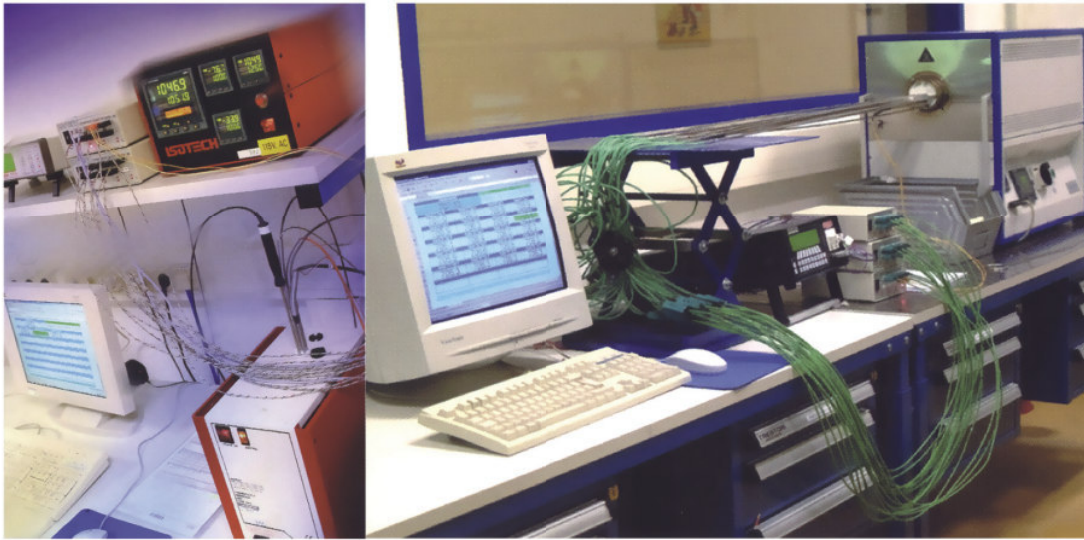

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА РУГОСЛАВИЈА  
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА РАДОВЕ, ЗАШТИТУ И  
ЖИВОТНО СРЕДИШЕ  
САВЕЗНИ СЛОВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
11000 Београд, Милош Аленић 14, Контакт Факс 766,  
Тел. 0113 32-82-738, телефакс: 0113 381-468

**РЕШЕЊЕ  
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕГЛЕД МЕРИЛА**

- Уговор је саопштен у складу са условима преговора између **ТЕРМОТЕХНА, Жабљак, Ј.Б. ТЕРМОТЕХНА, Чачак, Јединство улице 39, менаџер преговора термометара, отпорних термометара, мерила са термометрима и мерила са отпорним термометрима.**
- Преглед мерила по члану 8. овог решења вршиће одговорна организациона јединица Завода - Контролни одељење и преговорна места Крупањак,
- Избор надлежних организационих јединица у лабораторији и надлежних преговорних места по уговору на чл. 45. и 46. Закона,
- Ово решење важи до сувођине прописане уредбом из члана 46. Закона, а погледом на ЈАВ.С.Б.С.С.С.С.
- Преглед је уговорен да су испуњени услови прописани Прелиминарним описима за објекативну лабораторију за преглед термометара ("Службени лист СРЈ", бр. 34/96) и Прелиминарним описима за објективну лабораторију за преглед отпорних термометара ("Службени лист СРЈ", бр. 34/96).

Број Решења 24-01-2003  
Београд, 14.08.1998. године

**ДИРЕКТОР**  
Проф. др Милош Поповић, д.р.тс.тс.

**SERTIFIKAT**

Sertifikaciono telo  
TUV SÜD Management Service GmbH

**ТЕРМОТЕХНА** TERMOTEHNA Sušić d.o.o.  
Putev jedinstvo putje 18  
8100 - 33000 Čačak

za oblast  
Projekovanje, proizvodnja i prodaja termoelementa i otpornih termometara, WTK (resistance-free-wire) prijemnika i elektroničkih jedinica

uslovi sistema sprovođenja kvaliteta i da su primenjeni.  
Proverljivost, izveštaj broj 7871828  
potvrđeno je da su ispunjeni zahtevi prema standardu  
ISO 9001: 2000  
Ovaj sertifikat važi do 2008-11-22  
Registracioni broj sertifikata 12 100 23064 TMS

TUV SÜD Management Service GmbH - Zertifizierung • Referenznummer 01-8033 München • Germany

**CERTIFICATE**

The Certification Body  
of TÜV SÜD Management Service GmbH

**ТЕРМОТЕХНА** TERMOTEHNA Sušić d.o.o.  
Putev jedinstvo putje 18  
8100 - 33000 Čačak

has established and applies  
a Quality Management System for  
Design, manufacture and sales of thermo elements, resistance thermometers, multimeters and electronic control receivers

An audit was performed, Report No. 7871828  
Proof has been furnished that the requirements  
according to  
ISO 9001: 2000  
are fulfilled. This certificate is valid until 2008-11-22  
Certificate Registration No. 12 100 23064 TMS

TUV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierung • Referenznummer 01-8033 München • Germany

**o.o.o. INSTITUT ZA PREVENTIVU**  
ZASTITA NA RADU, PROTUPOZARNU ZASTITU I RAZVOJ • NOVI SAD  
11000 Novi Sad, Kraljeva Marka 11, Telefon: 021/620-011, 021/621-021/022

**SERTIFIKAT Br. 0087/2007**  
CERTIFICATE No.

Proizvođač/Proizvođač:  
Ime/Manufacturer:  
Podnošilac zahteva:  
Application:  
Datum proizvodnje:  
Date of production:  
Standard / propis:  
Standard / Regulation:  
Izveštaj o ispitivanju:  
Test Report No.  
Redovni važeći sertifikat:  
Certificate validity:

OTPORNI TERMOMETAR/TEMPERATURE ELEMENT  
Tip: TE 610  
Ex oznaka: Ex e II CT4..T8  
"TERMOTEHNA SUŠIĆ" D.O.O. - ČAČAK  
"TERMOTEHNA SUŠIĆ" D.O.O. - ČAČAK  
2008  
JUS N.S.B. 011:201221:301:321  
00812007-1  
2010.03.12.

Na osnovu izveštaja o ocenjivanju br. 0087/07 kome je sa sertifikacijom priloženo sa  
da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtevima navedenih standarda ili propisa.  
Based on the Evaluation Report of the Certificate Commission it is certified that the product  
characteristics are in conformity with the requirements of the cited standards/regulations.  
Izveštaj da se u ovom slučaju proizvodnja izlazi van domaćih mera i standarda, primenjuje  
specifičan i odobren. Proizvođač utvrđuje valjanost da u svim okolnostima proizvodnja, ispitivanja  
opisane zahtevima u skladu sa međunarodnim standardima i propisima za ovu vrstu proizvoda.  
The applicant will be exempted from doing activities as long as it is properly certified, controlled, used and  
maintained. Report of the applicant must be done only by certified personnel. Also, maintaining good records for the  
applicant's production is required until the expiration date of the certificate.

Mesto: Novi Sad  
Date: 2007.03.12.

INSTITUT ZA PREVENTIVU  
NOVI SAD  
Direktor

JUAT Akreditaciono telo Srbije, br. 04-010  
Accreditation Body of Serbia, No. 04-010

**o.o.o. INSTITUT ZA PREVENTIVU**  
ZASTITA NA RADU, PROTUPOZARNU ZASTITU I RAZVOJ • NOVI SAD  
11000 Novi Sad, Kraljeva Marka 11, Telefon: 021/620-011, 021/621-021/022

**SERTIFIKAT Br. 0088/2007**  
CERTIFICATE No.

Proizvođač/Proizvođač:  
Ime/Manufacturer:  
Podnošilac zahteva:  
Application:  
Datum proizvodnje:  
Date of production:  
Standard / propis:  
Standard / Regulation:  
Izveštaj o ispitivanju:  
Test Report No.  
Redovni važeći sertifikat:  
Certificate validity:

OTPORNI TERMOMETAR/TEMPERATURE ELEMENT  
Tip: TE 610  
Ex oznaka: Ex e II T4..T8  
"TERMOTEHNA SUŠIĆ" D.O.O. - ČAČAK  
"TERMOTEHNA SUŠIĆ" D.O.O. - ČAČAK  
2008  
JUS N.S.B. 011:201221  
00812007-2  
2010.03.12.

Na osnovu izveštaja o ocenjivanju br. 0088/07 kome je sa sertifikacijom priloženo sa  
da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtevima navedenih standarda ili propisa.  
Based on the Evaluation Report of the Certificate Commission it is certified that the product  
characteristics are in conformity with the requirements of the cited standards/regulations.  
Izveštaj da se u ovom slučaju proizvodnja izlazi van domaćih mera i standarda, primenjuje  
specifičan i odobren. Proizvođač utvrđuje valjanost da u svim okolnostima proizvodnja, ispitivanja  
opisane zahtevima u skladu sa međunarodnim standardima i propisima za ovu vrstu proizvoda.  
The applicant will be exempted from doing activities as long as it is properly certified, controlled, used and  
maintained. Report of the applicant must be done only by certified personnel. Also, maintaining good records for the  
applicant's production is required until the expiration date of the certificate.

Mesto: Novi Sad  
Date: 2007.03.12.

INSTITUT ZA PREVENTIVU  
NOVI SAD  
Direktor

JUAT Akreditaciono telo Srbije, br. 04-010  
Accreditation Body of Serbia, No. 04-010

Uverenja o odobrenju tipa merila

